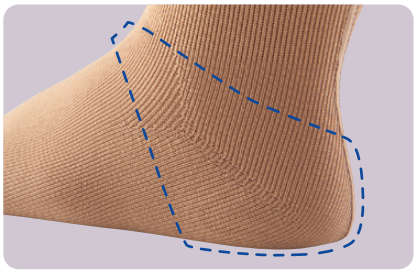
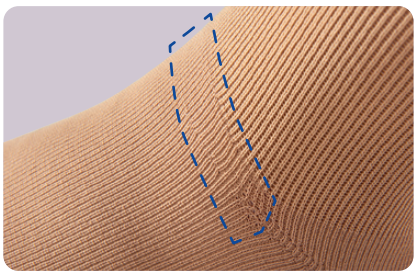
ZUSÄTZE FÜR BEIN UND FUß

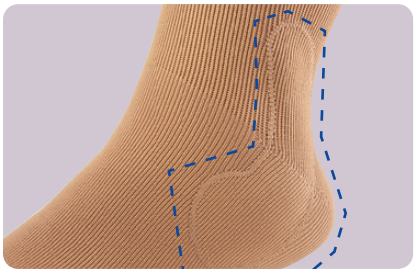
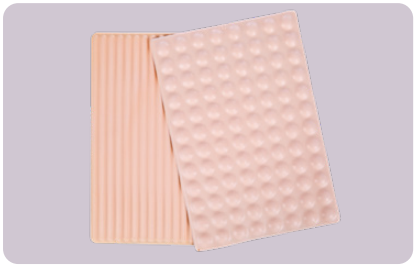
VenoTrain® curaflow und VenoTrain® curaflow strong

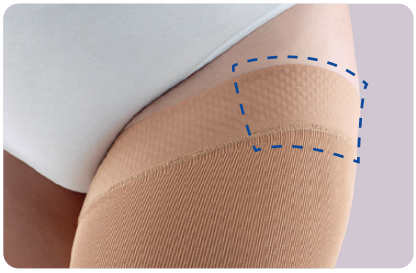
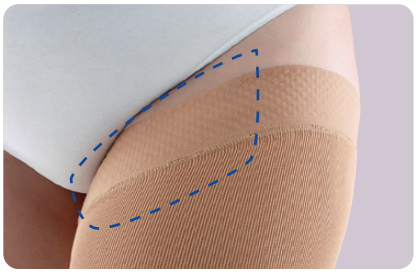
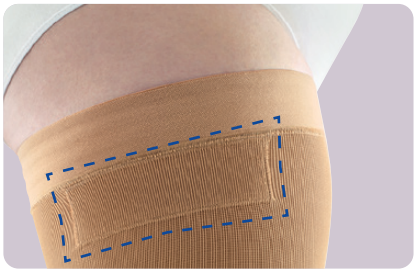
VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong ermöglichen durch Maßfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab.

Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produktkombinations-möglichkeiten. Weitere Zusätze können Sie in unserer aktuellen Preisliste nachschlagen.

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Schräger Fuß (geschlossen)		
	• ödematöser Fußrücken • Zehen- und Fußfehlstellungen	• erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken • anatomische Passform • kein Rutschen des Fußgestrickes nach hinten • Vermeidung des Rückstaus im Zehenbereich • sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze
Gerader Fuß (geschlossen)		
	• ödematöser Fußrücken bei relativ gerader Zehenlinie	• kein Rutschen des Fußgestrickes nach hinten • Vermeidung des Rückstaus in den Zehenbereich • sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze
Schräger Fuß (offen)		
	• ödematöser Fußrücken • Zehenfehlstellungen • Erkrankungen von Haut und Nagel im Zehenbereich	• erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken • anatomische Passform • distale Fixierung • Vermeidung zirkulärer Einschnürung und Entstehung eines Vorfußödems
Gerader Fuß (offen)		
	• bei unauffälliger Anatomie der Zehenanordnung und einer geraden Zehenlinie	• für verbesserte Luftzirkulation im Vorfußbereich

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Hallux 	• Schiefstand des Großzehs (Hallux valgus)	• optimale Passform im Halluxbereich • Druckentlastung
90°-Ferse 	• Hautfalten bei Y • ausgeprägte anatomische Ferse, wenn Malleolen oder Achillessehne nicht sichtbar ist • Rollstuhlfahrer und überwiegende sitzende Tätigkeiten • zur Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens	• keine Faltenbildung an Ferse und Spann • verbesserter Kompressionsverlauf im Knöchelbereich • bessere Gelenkfunktionalität
Spannerweiterung 	• Überhänge bei Y • hoher Spann • Lymphödem Stadium Ende 2 / Beginn 3	• geringerer Druck auf die Fußhebersehne • verbesserter Kompressions-verlauf am Fußrücken
nahtlose Zehenkappe (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymhödeme • Fußrückenödeme	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich • höhere Akzeptanz bei Tragekomfort dank Aussparung des Kleinzeh
Zehenkappe (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme • Fußrückenödeme	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich • höhere Akzeptanz bei Tragekomfort dank Aussparung des Kleinzeh
Zehenkappe mit Ringen (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme • Fußrückenödeme	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Zehen am Strumpf angenäht (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme • Fußrückenödeme	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich • keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil
Pelotte eingearbeitet 	• Ödeme und Verhärtungen im Knöchelbereich	• Erhöhung des punktuellen Drucks • Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen
Lymphpad mit Futterstoff 	• lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung • Abweichungen vom anatomischen Standard	• Erhöhung des punktuellen Drucks anhand gerippter und genoppter Lymphpads • Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen
Futterstoff 	• Hautirritation in den Beugebereichen wie Sprunggelenk und Knie, Pergamenthaut	• Schutz empfindlicher Haut vor Überbelastung • Verringerung von Reibung und mechanischer Belastung • Fixierung von Pelotten
Funktionszone Standard bei allen Beinversorgungen am Knie 	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten	• extraweiche Kniekehle für verminderte Faltenbildung • anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalitäten
Abschluss schräg am Knie 	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten empfohlen • konische anatomische Form • weiches Hautgewebe	• verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich (AD) • anatomische Passform

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Abschluss schräg am Oberschenkel 	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten empfohlen • konische anatomische Form • weiches Hautgewebe	• vermeidet zirkuläres Einschnüren der Lymphgefäße • verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich (AG) • anatomische Passform
Beinerhöhung vorn nur in Kombination mit Abschluss schräg möglich 	• Patienten mit voluminösem, ödembetontem Oberschenkel	• Verhinderung von Einschnürungen • physiologischer Druckverlauf bis in die Leiste
Haftbandstück 	• ausgeprägte konische Beinform • sehr weiches Gewebe	• zusätzlicher Halt
Herrenzwickel Standard 	• Strumpfhosen für die Herrenversorgung	• verbesserte Passform des Leibteils

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Stomaöffnung 	• Abdomen	• ermöglicht den Zugang zu externen Ableitungen / Zuleitungen
ATU-Zwickel 	• Schwangerschaft	• verbesserte Passform des Leibteils • verminderte Kompression im Bereich des Leibes
Hüftbefestigung 	• Haftbandunverträglichkeit	• Halt der Kompressions-bestrumpfung
Reißverschluss 	• bei großen Umfangsdifferenzen von Hüfte und Taille • bei körperlichen und gesund-heitlichen Einschränkungen, wie bspw. schlaffen Paresen, Arthrose, Rheumatische Veränderungen im Finger / Handbereich oder Inkontinenz	• erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

ZWICKELARTEN

Zwickel Standard ohne Wäscheschutz



Dies ist die Standardversorgung, welche mit einer einzelnen Stofflage gut geeignet ist für die Nutzung von Hygieneartikeln und ein Einschneiden im Intimbereich verhindert.

Zwickel Standard mit Wäscheschutz



Durch die doppelte Stofflage kommt es zu keinen Reibungen oder Reizungen im Intimbereich. Desweiteren dient sie der Absorption von Schweiß und Ausfluss und verringert somit das Risiko von Infektionen.

Zwickel kompressiv ohne Wäscheschutz



Die sehr gute Passform verhindert ein Verrutschen und ermöglicht einen besseren Sitz des Gestricks. Unterstützt die Minimierung von Genitalödemen.

Zwickel kompressiv mit Wäscheschutz



Die sehr gute Passform verhindert ein Verrutschen und ermöglicht einen besseren Sitz des Gestricks. Die doppelte Stofflage verhindert außerdem Reibungen und Hautreizungen im Intimbereich.

Zwickel überlappend



Ermöglicht eine postoperative Anwendung bei Patienten mit Katheterversorgung und erleichtert den Toilettengang.